



ENTWERFEN
HERSTELLEN
BEHERRSCHEN



FDA-KONFORME
MASKEN AUS
SILIKON, FKM
ODER EPDM



DIN EN ISO
9001:2015

MASKIERUNG ORTHOPÄDISCHER IMPLANTATE ZUR TITAN- UND HAP-PLASMASPRITZBESCHICHTUNG

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE


- Food and Drug Administration (FDA)
- US Pharmacopeia (USP)
- Zertifizierung ISO 9001:2015



ANWENDUNGSBEISPIEL

Maskierung spezieller
Bereiche einer Gelenkpfanne
vor Durchführung des
Plasmaspritzbeschichtung
oder verfahren


Abdeckstopfen



Gelenk-
Pfanne




Abdeckring



Abdeckteile für
Tibiaplateaus



Abdeckteile für Femurkondylen

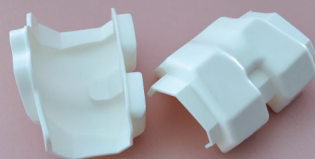

SPEZIALISIERUNG

Entwurf und Herstellung von FDA-Gummiteilen als Zwischenprodukt bei der Fertigung orthopaedischer Implantate (Gelenkpfannen, Hüftschäfte, Femurkondylen, Tibiaplateaus, Glenoidkomponente, Schulterchaft usw.)

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE

- Food and Drug Administration (FDA)
- US Pharmacopeia (USP)
- Zertifizierung ISO 9001:2015


UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM

KNOW-HOW

- Elastomerteile, hergestellt im Spritzgiess- und Formpressverfahren unter Vakuum
- PTFE-Teile, hergestellt im Sinterform-Verfahren unter Reinraumbedingung

SUPPORT


- Technische Unterstützung bei der Wahl des geeigneten Werkstoffes
- Entwicklungsübernahme und Werkzeugrealisation auf Anfrage
- Mithilfe bei der Produktentwicklung

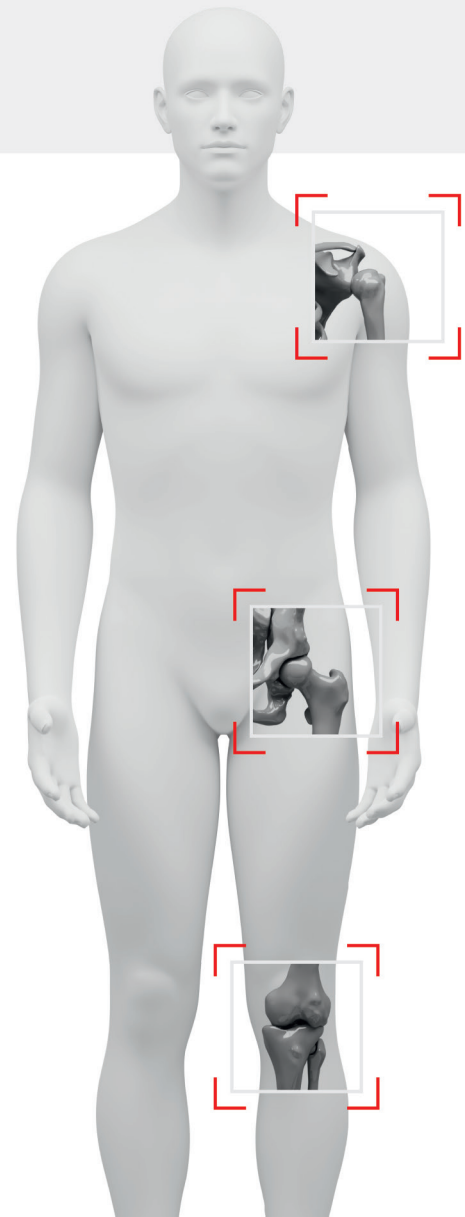

INTERCARAT

10 Rue Georges Guynemer
F - 67120 ALTORF / FRANCE
Tel.: +33 (0)3 88 48 21 20
E-mail: sales@intercarat.com

www.intercarat.com



DIN EN ISO
9001:2015